



### **Phantom®2 Nasal Vented Mask**

Máscara nasal con ventilación Phantom®2

Máscara nasal com ventilação Phantom®2

Назальная вентилируемая маска Phantom®2

Phantom®2 開孔口付き鼻マスク

قناع أنفی بفتحات تنفس Phantom®2

מַסְכַּת אֲפָי בְּעֵלֶת חֹורִי אוֹרָוֹר - Phantom®2

**These instructions contain the following languages:**  
English, Spanish, Portuguese, Russian, Japanese, Arabic and Hebrew



#### **Sleepnet Corporation**

5 Merrill Industrial Drive  
Hampton, NH 03842 USA


Tel: (603) 758-6600

Fax: (603) 758-6699


Toll Free: 1-800-742-3646 (USA)

[www.sleepnetmasks.com](http://www.sleepnetmasks.com)


## התאמת לפנים / ازدائ / Colocar/ Подгонка/ 取付

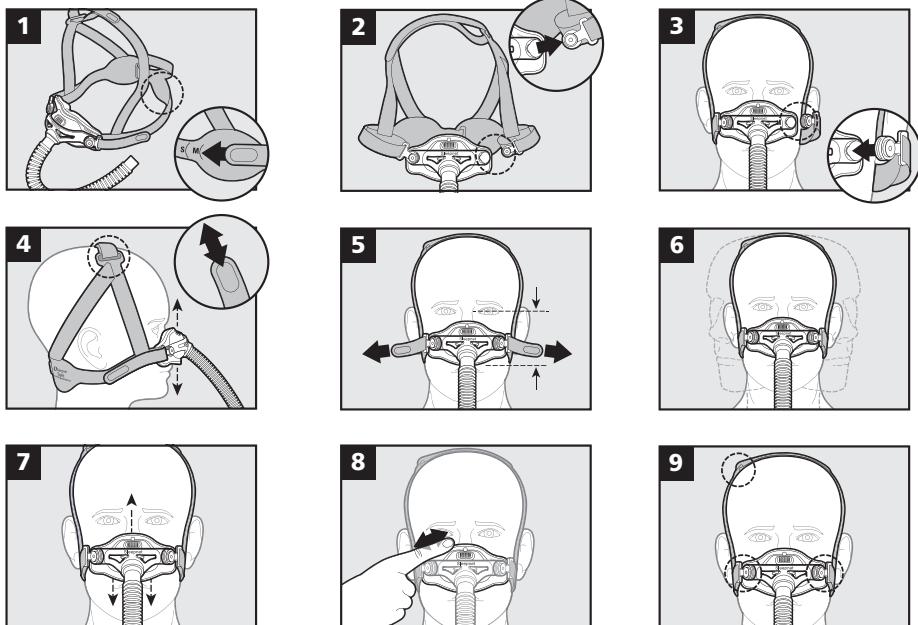

## פירוק / إفك / Desmontaje/ Desmontar/ Разборка/ 分解

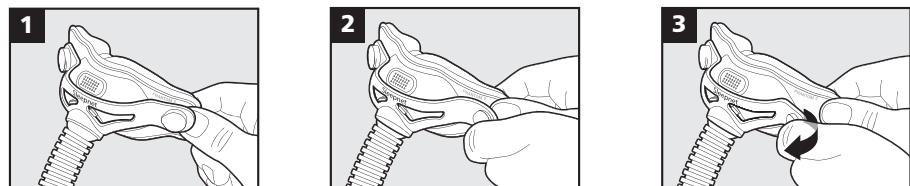


## הרכבה / التركيب / Montaje/ Montar/ Сборка/ 組み立て

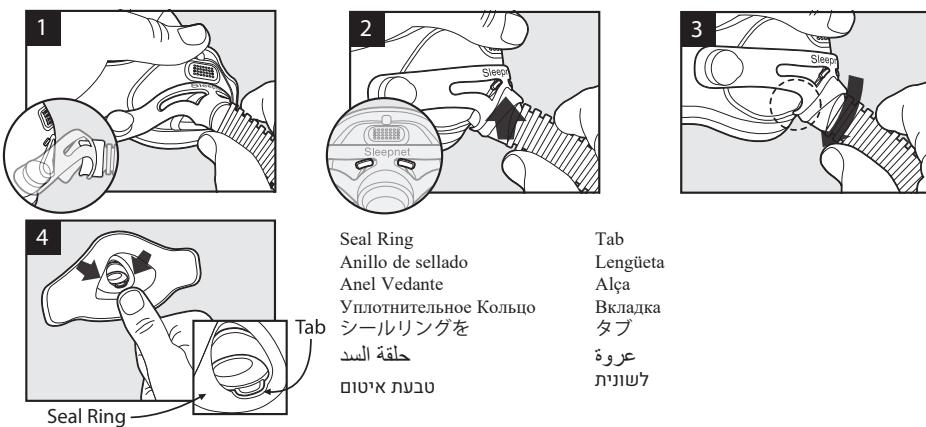


Seal Ring  
Anillo de sellado  
Anel Vedante  
Уплотнительное Кольцо  
シールリングを  
حلقة السد  
תבעת איטום

Tab  
Lengüeta  
Alça  
Вкладка  
タブ  
عروة  
לשונית

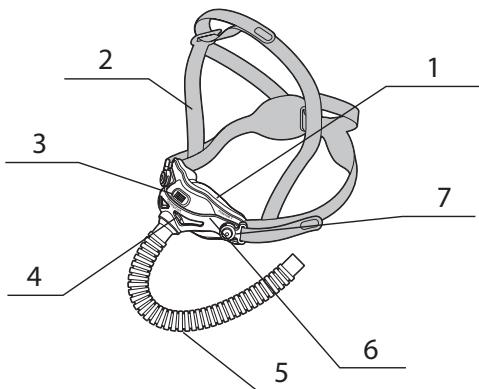

1. **Phantom®2** Cushion
2. TruFit Headgear
3. Vent
4. Mask Posts
5. Hose
6. Swivel Frame
7. Magnet

1. **Phantom®2** クッション
2. TruFit ヘッドギア
3. 通気口
4. マスクポスト
5. ホース
6. 回りフレーム
7. マグネット

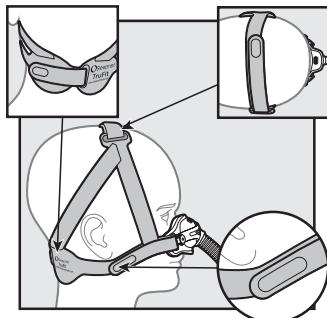

- Phantom®2**
- .1. وسادة
  - .2. طقم رأس TruFit
  - .3. فتحة
  - .4. حمائل القاع
  - .5. خرطوم
  - .6. إطار الوصلة المتراوحة
  - .7. مغناطيس

1. Almohadilla **Phantom®2**
2. Correas sujetadoras TruFit
3. Ventilación
4. Posiciones de la máscara
5. Manguera
6. Estructura giratoria
7. Imán

- Phantom®2**
- .1. כרית **Phantom®2**
  - .2. ייחידתרכזותהראש TruFit
  - .3. חור אווורור
  - .4. שינוי המסכה
  - .5. צינור
  - .6. מסגרת סיבוב
  - .7. מגנט

1. Almofada **Phantom®2**
2. Acessório para cabeça TruFit
3. Orifício de ventilação
4. Saliências da máscara
5. Tubo
6. Armação giratória
7. Íman

1. Подушка **Phantom®2**
2. Система фиксации на голове TruFit
3. Вентиляционное отверстие
4. Стойки маски
5. Шланг
6. Поворотный каркас
7. Магнит


## VENT HOLE PRESSURE/FLOW CHARACTERISTICS (Approx.)

CARACTERÍSTICAS DE PRESIÓN/FLUJO DEL ORIFICIO DE VENTILACIÓN (Aprox.)  
CARACTERÍSTICAS DE PRESSÃO/FLUXO DO ORIFÍCIO DE VENTILAÇÃO (Aprox.)  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАВЛЕНИЯ/РАСХОДА В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЯХ (приблизительные)

開孔口にかかる圧力/流れの特徴（近似値）

خصائص ضغط/تدفق فتحة التنفس (تقريبية)

מאפייני לחץ/זרימה דרך האוורור (בקירוב)

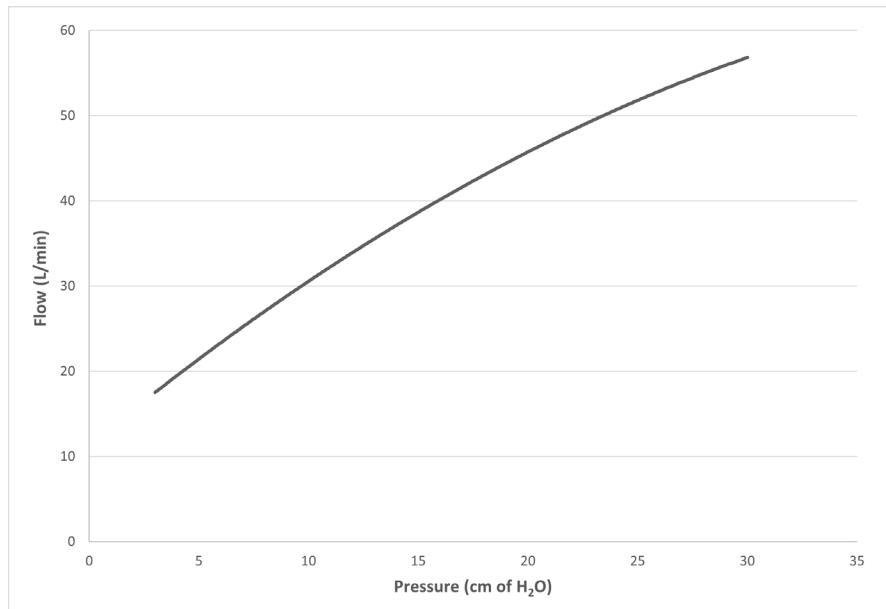

### Vent Flow (L/min)

Flujo de ventilación

Fluxo de ventilação

Расход вентиляционного воздуха

換気流

تدفق التنفس

זרימת אוורור (ל'/דקה)

### Mask Pressure (cm H<sub>2</sub>O)

Presión de la máscara

Pressão da máscara

Давление в маске

マスク圧

ضغط القناع

לחץ מסכה (ס"מ מים)



The **Phantom®2** Nasal Vented Mask is intended to be used with positive airway pressure devices, such as CPAP or bi-level, operating at or above 3 cm H<sub>2</sub>O. The mask is to be used on adult patients (>30kg) for whom positive airway pressure therapy has been prescribed. The mask is intended for single-patient multi-use in the home, hospital or institutional environment.

## NOTES

- This product is not manufactured with natural rubber latex.
- If the patient has ANY reaction to any part of the mask system, discontinue use.
- An exhalation port is built into this mask so a separate exhalation port is not required.

## CONTRAINDICATIONS

Do not use this mask if you or anyone (example: household members, bed partners, caregivers, etc.) in close physical contact with your mask has an active medical implant or metallic implant that will interact with magnets. Implant examples include, but are not limited to, pacemakers, implantable cardioverter defibrillators (ICD), neurostimulators, aneurysm clips, metallic stents, ocular implants, insulin/infusion pumps, cerebral spinal fluid (CSF) shunts, embolic coils, metallic splinter, implants to restore hearing or balance with implanted magnets (such as cochlear implants), flow disruption devices, contact lenses with metal, dental implants, metallic cranial plates, screws, burr hole covers, bone substitute device, magnetic metallic implants/electrodes/valves placed in upper limbs, torso, or higher, etc. If you have any questions regarding the implant, consult your physician or the manufacturer of your implant.

## CAUTIONS

- U.S. Federal Law restricts this device for sale by or on the order of a physician.
- Do not expose the **Phantom®2** Nasal Vented Mask to temperatures above 122°F (50°C).
- This mask is intended for single patient use only. It may be cleaned and used repeatedly on the same person but must not be used on multiple persons. Do not sterilize or disinfect.

## WARNINGS

- This mask is not suitable for providing life support ventilation.
- Do not use the **Phantom®2** Nasal Vented Mask with baseline pressure less than 3 cm H<sub>2</sub>O.
- If oxygen is used with this CPAP mask, the oxygen flow must be turned off when the CPAP machine is not operating. Explanation of the warning: When the CPAP device is not in operation, and the oxygen flow is left on, oxygen delivered into the ventilator tubing may accumulate within the CPAP machine enclosure. Oxygen accumulated in the CPAP machine enclosure will create a risk of fire.
- At a fixed rate of supplemental oxygen flow, the inhaled oxygen concentration will vary, depending on the pressure settings, patient breathing pattern, mask selection, and the leak rate.
- No smoking or open flames such as candles may be used when oxygen is in use.
- To minimize the risk of vomiting during sleep, avoid eating or drinking for three (3) hours before using the mask.
- Any unusual skin irritation, chest discomfort, shortness of breath, gastric distension, abdominal pain, belching or flatulence from ingested air, or severe headache experienced by the patient during or immediately after use should be immediately reported to a healthcare professional.
- Using a mask may cause tooth, gum or jaw soreness or aggravate an existing dental condition. If symptoms occur, consult a physician or dentist.
- Consult a physician if any of the following symptoms occur while using the mask: drying of the eyes, eye pain, eye infections, or blurred vision. Consult an ophthalmologist if symptoms persist.
- Do not overtighten the headgear straps. Signs of overtightening include: excessive redness, sores, or bulging skin around the edges of the mask. Loosen headgear straps to alleviate symptoms.
- At low CPAP pressures, the flow through the exhalation ports may be inadequate to clear all exhaled gas from the tubing. Some rebreathing may occur.
- This mask should be used with the positive airway pressure device recommended by a physician or respiratory therapist. The mask should not be used unless the positive airway pressure device is turned on and operating properly. Do not block or try to seal the exhalation port (vent holes). The vent holes allow a continuous flow of air out of the mask. When the positive airway pressure device is turned on and functioning properly, new air from the device flushes the exhaled air out through the mask's vent holes. When the positive airway pressure device is not operating, exhaled air may be rebreathed. Rebreathing of exhaled air can, in some circumstances, lead to suffocation. This warning applies to most models of CPAP machines and masks.

- This mask is not intended for patients without a spontaneous respiratory drive. This mask should not be used on patients who are uncooperative, obtunded, unresponsive, or unable to remove the mask. This mask may not be suitable for persons with the following conditions: impaired cardiac sphincter function, excessive reflux, impaired cough reflex, and hiatal hernia.
- Significant leak may occur without properly fitting the mask.
- Magnets are used in the mask and headgear clips with a field strength of 380mT. With the exception of the devices identified in the contraindication, ensure that the mask is kept at least 6 inches (approx.16 cm) away from any other medical implants or medical devices that can be impacted by the magnetic fields to avoid possible effects from localized magnetic fields. This applies to you or anyone in close physical contact with your mask.

### **GENERAL INFORMATION**

Dispose of the mask and accessories in accordance with local and regional guidelines.

This mask has a non-transferable three month limited warranty for manufacturer's defects from the date of purchase by the initial consumer (or maximum service life, if shorter). If a mask used under normal conditions should fail, Sleepnet will replace the mask. For additional information about the Sleepnet Warranty, please visit <http://www.sleepnetmasks.com/>.

**NOTE:** The mask cushion has a service life of the 1 month. The swivel frame/tube set has a service life of 3 months. The TruFit Headgear and magnetic clips have a service life of 6 months.

### **CLEANING AND MAINTENANCE**

Cleaning is recommended on a daily basis. Refer to disassembly instructions. Wash the mask and components in warm water using a mild soap such as Ivory®. Rinse the mask thoroughly after washing. Visually verify that the vent holes are clear and allow the mask to air dry. Washing your face prior to fitting the mask will remove excess facial oils and help extend the life of the mask.

**NOTE:** The gel cushion, although silky to touch, will not tear, leak or detach from the mask under normal use and following recommended cleaning and maintenance protocols. However, the gel cushion is not indestructible. It will tear, cut and rip if subjected to mishandling or abuse. Do not clean in a dishwashing machine. The warranty does not cover these types of product failures. Therefore, please handle your new **Phantom®2** Nasal Vented Mask with care.

**WARNING:** Frequency of cleaning, methods of cleaning or the use of cleaning agents, other than those specified above, or exceeding the service life of the components can have an adverse effect on the device and consequently the safety or the quality of the therapy.

### **TECHNICAL INFORMATION**

Therapy pressure range: 3 to 30 cm H<sub>2</sub>O

Resistance to air flow at 50 L/min: 0.45 cm H<sub>2</sub>O

Resistance to air flow at 100 L/min: 2.06 cm H<sub>2</sub>O

DEAD SPACE VOLUME (mL approx.): Mask – 30.7ml Tube – 68.3ml

Operating Temperature: Do not expose the mask to temperatures above 122°F (50°C).

### **BEFORE USE**

- Inspect mask daily or prior to each use. Replace the mask if vent holes are blocked, if parts are damaged, or if gel is exposed due to tears or punctures.

### **PHANTOM®2 FITTING INSTRUCTIONS**

1. Take mask out of the bag. Adjust the base strap according to your general size by aligning the tab at the indicated size markings (S, M, L, XL). (Figure 1).
2. Detach one magnetic clip from the mask. (Figure 2).
3. After placing the mask on your head, reattach the magnetic clip. (Figure 3).
4. First, adjust the top strap to raise or lower the mask. (Figure 4).
5. Second, adjust the left/right straps to make sure the bottom of the mask is sealed comfortably between the bridge of the nose and just above the upper lip. (Figure 5).
6. Connect the mask to the possible airway pressure device tubing and turn the device on to the prescribed pressure. Turn head from side to side while lying on the bed to assure secure fit. (Figure 6).
7. If unacceptable leaks occur, try moving the mask higher or lower around the nose to find the best fit. (Figure 7).
8. Gently press edges of the mask to change mask shape, create a comfortable fit, and reduce leaks. (Figure 8).
9. If leaks persist, try moving the mask higher or lower around the nose to find the best fit. (Figure 9).

## **DISASSEMBLY INSTRUCTIONS**

1. Firmly hold the mask cushion in one hand to one side. (Figure 1).
2. Grasp the swivel frame by one of the magnets. (Figure 2).
3. Firmly pull to separate the Swivel Frame from the cushion in a peeling motion. (Figure 3).

## **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

1. Hold the Swivel Frame up to the mask, slightly tilted up (Figure 1). Using your fingers, support the mask seal ring from inside.
2. Slide the top part of the Swivel Frame into the mask until the mask posts lock into the Swivel Frame grooves (Figure 2).
3. Softly push the bottom part of the Swivel Frame into the mask until the Swivel Frame tab locks into place (Figure 3).
4. Visually inspect inside the mask to ensure that the seal ring is properly seated onto the Swivel Frame (Figure 4).

**Phantom®2** is a trademark of Sleepnet Corporation.

Visit our website at [www.sleepnetmasks.com](http://www.sleepnetmasks.com)

## **Instrucciones de uso de la máscara nasal con ventilación *Phantom®2***

ESPAÑOL



La máscara nasal con ventilación **Phantom®2** se diseñó para usarse con dispositivos de presión positiva de las vías respiratorias, como CPAP o de dos niveles, operando a 3 cm H<sub>2</sub>O o más. La máscara es para pacientes adultos (> 30 kg) a quienes se les recetó una terapia de presión positiva de las vías respiratorias. Está destinada a un único paciente que podrá usarla varias veces en su casa, en el hospital o en un entorno institucional.

### **NOTAS**

- Este producto no se fabricó con látex de caucho natural.
- Si el paciente tiene ALGUNA reacción a cualquier pieza de la máscara, suspenda su uso.
- La máscara viene con un puerto de exhalación integrado, por lo que no se requiere un puerto de exhalación separado.

### **CONTRAINDICACIONES**

No use esta máscara si usted o cualquier otra persona (por ejemplo: miembros de su hogar, compañeros de cama, cuidadores, etc.) que están en contacto físico cercano con la máscara tienen un implante médico activo o un implante metálico que interactúa con imanes. Algunos ejemplos de implantes incluyen, marcapasos, desfibriladores cardioversores implantables (ICD), neuroestimuladores, clips para aneurismas, stents metálicos, implantes oculares, bombas de insulina/infusión, derivaciones de líquido cefalorraquídeo (CSF), embolización con espirales, splinters metálicos, implantes para restaurar la audición o el equilibrio con imanes implantados (como implantes cocleares), disruptores de flujo, lentes de contacto con metal, implantes dentales, placas metálicas craneales, tornillos, cubiertas para agujeros de trépano, dispositivos de sustitución ósea, válvulas/implantes/electrodos metálicos magnéticos colocados en extremidades superiores, tronco o área superior, etc. Si tiene alguna pregunta acerca del implante, consulte a su médico o al fabricante de su implante.

### **PRECAUCIONES**

- La Ley Federal de EE. UU. limita este dispositivo para la venta por orden de un médico.
- No exponga la máscara nasal con ventilación **Phantom®2** a temperaturas superiores a los 122°F (50°C).
- Esta máscara se diseñó para que la use un único paciente. La misma persona puede limpiar y usar varias veces la máscara, pero no pueden usarla diferentes personas. No la esterilice ni la desinfecte.

### **ADVERTENCIAS**

- Esta máscara no es apta para proporcionar ventilación de apoyo vital.
- No use la máscara nasal con ventilación **Phantom®2** con una presión de referencia menor a 3 cm H<sub>2</sub>O.
- Si va a usar oxígeno con esta máscara CPAP, debe apagar el flujo de oxígeno cuando la máquina CPAP no está funcionando. Explicación de la advertencia: Cuando el dispositivo CPAP no está en funcionamiento y el flujo de oxígeno queda encendido, el oxígeno que ingresa al tubo de ventilación podría quedar acumulado dentro del cerramiento de la máquina CPAP. El oxígeno acumulado en el cerramiento de la máquina CPAP genera un riesgo de incendio.

- Con un caudal fijo de flujo de oxígeno complementario, la concentración de oxígeno inhalado variará según los ajustes de presión, el ritmo respiratorio del paciente, la selección de máscara y el índice de escape.
- No se debe fumar ni deben usarse llamas abiertas, como velas, cuando se está usando oxígeno.
- Para minimizar el riesgo de vómitos mientras duerme, evite comer o beber durante las tres (3) horas previas al uso de la máscara.
- Cualquier irritación inusual de la piel, molestia en el pecho, dificultad para respirar, distensión gástrica, dolor abdominal, eructación o flatulencias por el aire ingerido, o si el paciente experimenta dolor de cabeza intenso durante el uso de la máscara, o inmediatamente después, debe informarse de inmediato a un profesional de la atención médica.
- El uso de una máscara podría generar dolor en dientes, encías o mandíbula, o podría agravar una afección dental existente. En caso de tener síntomas, consulte con un médico o dentista.
- Si experimenta sequedad ocular, dolor ocular, infecciones oculares o visión borrosa, entre otros síntomas, mientras usa la máscara, consulte a su médico. Consulte con un oftalmólogo si los síntomas persisten.
- No ajuste de más las correas sujetadoras. Algunas señales que indican que ajustó de más las correas son: enrojecimiento excesivo, irritación o piel abultada alrededor de los bordes de la máscara. Afloje las correas para aliviar los síntomas.
- En presiones de CPAP bajas, el flujo que pasa por los puertos de exhalación podría no ser adecuado para despejar todo el gas exhalado de los tubos. Podría haber cierta reinhalación.
- Esta máscara debería usarse con el dispositivo de presión positiva de las vías respiratorias recomendado por un médico o terapeuta respiratorio. No debería usarse la máscara a menos que el dispositivo de presión positiva de las vías respiratorias esté encendido y funcione correctamente. No bloquee ni intente sellar el puerto de exhalación (orificios de ventilación). Los orificios de ventilación permiten la salida de un flujo de aire continuo de la máscara. Cuando el dispositivo de presión positiva de las vías respiratorias está encendido y funciona correctamente, el nuevo aire del dispositivo purga el aire exhalado a través de los orificios de ventilación de la máscara. Cuando el dispositivo de presión positiva de las vías respiratorias no está funcionando, es posible que se vuelva a inhalar el aire exhalado. En algunas circunstancias, la reinhalación del aire exhalado puede causar sofocación. Esta advertencia aplica a la mayoría de los modelos de máquinas y máscaras CPAP.
- Esta máscara no está destinada a pacientes sin actividad respiratoria espontánea. Esta máscara no debe usarse en pacientes que no pueden cooperar, están embotados, no son receptivos o no pueden quitarse la máscara. Esta máscara podría no ser apta para personas con estas afecciones: función de esfinter de cardias deficiente, reflujo excesivo, reflujo de los deteriorado y hernia de hiato.
- Si no se ajusta la máscara de manera adecuada podría producirse un escape importante.
- En las correas sujetadoras y la máscara se utilizan imanes con una intensidad de campo de 380 mT. Excepto por los dispositivos identificados en la contraindicación, asegúrese de mantener la máscara como mínimo a una distancia de 6 pulgadas (aprox. 16 cm) de cualquier otro implante o dispositivo médico que pueda verse afectado por los campos magnéticos para evitar posibles efectos debido a los campos magnéticos localizados. Esto se aplica a usted o a cualquier otra persona que esté en contacto físico cercano con la máscara.

### **INFORMACIÓN GENERAL**

Deseche la mascarilla y sus accesorios de acuerdo con lo establecido en la normativa local y regional. Esta mascarilla cuenta con una garantía limitada e intransferible durante un período de tres meses para defectos de fabricación desde la fecha de compra por el cliente inicial (o la duración máxima, si es más corta). En caso de que falle la mascarilla bajo condiciones de uso normales, Sleepnet la sustituirá. Para saber más sobre la garantía de Sleepnet, consulte: <http://www.sleepnetmasks.com/>.

**NOTA:** La almohadilla de la mascarilla tiene una duración de 1 mes. El conjunto de la montura giratoria y el tubo tiene una duración de 3 meses. El arnés TruFit y los clips magnéticos tienen una duración de 6 meses.

### **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Se recomienda limpiar el equipo diariamente. Consulte las instrucciones de desmontaje. Lave la máscara y los componentes con agua tibia y un jabón suave, como Ivory®. Enjuague la máscara cuidadosamente después de lavarla. Verifique visualmente que los orificios de ventilación estén despejados y deje secar la máscara al aire. Lávese la cara antes de ajustarse la máscara para retirar el exceso de oleosidad facial; esto extenderá la vida útil de la máscara.

**NOTA:** Si bien la almohadilla de gel se siente suave al tacto, no debería tener fugas, romperse ni desprenderse de la máscara en condiciones de uso normales y si se siguen estos protocolos recomendados para la limpieza y el mantenimiento. Sin embargo, la almohadilla de gel no es indestructible. Se romperá, cortará y rasgará si se la maltrata o se la usa de manera incorrecta. No la lave en el lavavajillas. La garantía no cubre estos tipos de fallas de productos. Por lo tanto, maneje su máscara nasal con ventilación **Phantom®2** con cuidado.

**ADVERTENCIA:** La frecuencia de limpieza, los métodos de limpieza o el uso de agentes limpiadores, que no sean los especificados anteriormente, o exceder la vida útil de los componentes pueden tener un efecto adverso en el dispositivo y, en consecuencia, en la seguridad o la calidad de la terapia.

### **INFORMACIÓN TÉCNICA**

Rango de presión de terapia: 3 a 30 cm H<sub>2</sub>O

Resistencia al flujo del aire a 50 l/min: 0,45 cm H<sub>2</sub>O

Resistencia al flujo del aire a 100 l/min: 2,06 cm H<sub>2</sub>O

VOLUMEN DE ESPACIO MUERTO (ml aprox.): Mascarilla – 30,7 ml Tubo – 68,3 ml

Temperatura de funcionamiento: no exponga la mascarilla a temperaturas superiores a 122°F (50 °C).

### **ANTES DE USAR**

- Inspeccione la máscara todos los días o antes de cada uso. Reemplace la máscara si los orificios de ventilación estuvieran bloqueados, si las piezas estuvieran dañadas o si el gel quedara expuesto por roturas o perforaciones.

### **INSTRUCCIONES PARA EL AJUSTE PHANTOM®2**

1. Saque la máscara de la bolsa. Ajuste la correa de la base según su tamaño general alineando la lengüeta en las marcas de tamaño indicadas (S, M, L o XL). (Figura 1).
2. Desprenda un sujetador magnético de la máscara. (Figura 2).
3. Después de colocarse la máscara en la cabeza, vuelva conectar el sujetador magnético. (Figura 3).
4. Primero, ajuste la correa superior para elevar o bajar la máscara. (Figura 4).
5. Segundo, ajuste las correas izquierda/derecha para asegurarse de que la parte inferior de la máscara quede sellada cómodamente entre el puente de la nariz y apenas por encima del labio superior. (Figura 5).
6. Conecte la máscara al tubo del dispositivo de presión posible de las vías respiratorias y encienda el dispositivo según la presión recetada. Gire la cabeza de un lado al otro mientras está recostado en la cama para asegurarse de que esté ajustada de manera segura. (Figura 6).
7. En caso de haber escapes inaceptables, intente mover la máscara más arriba o más abajo alrededor de la nariz para encontrar el mejor ajuste. (Figura 7).
8. Presione suavemente los bordes de la máscara para cambiar la forma de la máscara, crear un ajuste cómodo y reducir escapes. (Figura 8).
9. Si las fugas persisten, intente mover la máscara más arriba o más abajo alrededor de la nariz para encontrar el mejor ajuste. (Figura 9).

### **INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE**

1. Sostenga firmemente la almohadilla de la máscara con una mano a un lado. (Figura 1).
2. Tome la estructura giratoria por uno de los imanes. (Figura 2).
3. Por último, tire de la estructura giratoria para separarla de la almohadilla. (Figura 3).

### **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

1. Sostenga la estructura giratoria arriba hacia la máscara, ligeramente inclinada (Figura 1). Sostenga el anillo de sellado de la máscara con los dedos desde adentro.
2. Deslice la parte superior de la estructura giratoria hacia el interior de la máscara hasta que las posiciones de la máscara queden bloqueadas en las ranuras de la estructura giratoria (Figura 2).
3. Presione suavemente la parte inferior de la estructura giratoria hacia dentro de la máscara hasta que la lengüeta quede bloqueada en su lugar (Figura 3).
4. Inspeccione visualmente el interior de la máscara para asegurarse de que el anillo de sellado quede debidamente situado en la estructura giratoria (Figura 4).

**Phantom®2** es una marca de Sleepnet Corporation.

Consulte nuestra página web en: [www.sleepnetmasks.com](http://www.sleepnetmasks.com).

# Instruções de utilização da máscara nasal

## com ventilação **Phantom®2**

PORTUGUÊS



A máscara nasal com ventilação **Phantom®2** destina-se a ser utilizada com dispositivos de pressão positiva nas vias respiratórias, tais como CPAP ou de nível duplo, com funcionamento a ou acima de 3 cm H<sub>2</sub>O. A máscara deve ser utilizada por pacientes adultos (>30 kg) para os quais foi prescrita a terapia de pressão positiva nas vias respiratórias. A máscara destina-se a um único paciente, mas de multiutilização em casa, no hospital ou ambiente institucional.

### NOTAS

- Este produto não é fabricado com látex de borracha natural.
- Se o paciente apresentar QUALQUER tipo de reação a qualquer peça do sistema da máscara, pare a utilização.
- Esta máscara inclui uma porta de expiração, pelo que não é necessária uma porta separada.

### CONTRAINDICAÇÕES

Não utilize esta máscara se você ou qualquer pessoa (por exemplo: membros da família, companheiros de cama, cuidadores, etc.) em contacto físico próximo com a sua máscara tiver um implante médico ativo ou implante metálico que irá interagir com ímanes. São exemplos de implantes , mas não apenas, pacemakers, cardioversores-desfibriladores implantáveis (CDI), neuroestimuladores, clipes de aneurisma, stents metálicos, implantes oculares, bombas de insulina/infusão, shunts de líquido cefalorraquídiano (LCR), bobinas embólicas, estilhaços metálicos, implantes para restaurar a audição ou o equilíbrio com ímanes implantados (como implantes cocleares), dispositivos de interrupção de fluxo, lentes de contacto com metal, implantes dentários, placas craniais metálicas, parafusos, tampas de orifícios de trepanação, dispositivo substituto ósseo, implantes/eléktrodos/válvulas metálicos magnéticos colocados em membros superiores, tronco ou mais acima, etc. Se tiver alguma dúvida sobre o implante, consulte o seu médico ou o fabricante do seu implante.

### PRECAUÇÕES

- A Lei Federal dos Estados Unidos apenas permite a venda deste dispositivo com receita médica.
- Não exponha a máscara nasal com ventilação **Phantom®2** a temperaturas superiores a 50 °C.
- Esta máscara destina-se a ser utilizada por um único paciente. Pode ser limpa e usada repetidamente na mesma pessoa, mas não deve ser utilizada em várias pessoas. Não esterilize nem desinfete.

### ADVERTÊNCIAS

- Esta máscara não é adequada para ventilação de suporte de vida.
- Não use a máscara nasal com ventilação **Phantom®2** com pressão de base inferior a 3 cm H<sub>2</sub>O.
- Se for utilizado oxigénio com esta máscara CPAP, o fluxo de oxigénio deverá ser desligado quando o aparelho CPAP não estiver a funcionar. Explicação da advertência: quando o aparelho CPAP não estiver a funcionar e o fluxo de oxigénio é deixado ligado, o oxigénio fornecido pelo tubo do ventilador poderá acumular-se na estrutura do aparelho CPAP. O oxigénio acumulado na estrutura do aparelho CPAP irá criar risco de incêndio.
- A uma taxa fixa de fluxo de oxigénio suplementar, a concentração de oxigénio inalado irá variar, dependendo das definições de pressão, do padrão de respiração do paciente e da taxa de fuga.
- É proibido fumar ou fazer chamas abertas, como velas, quando o oxigénio está a ser utilizado.
- Para minimizar o risco de vômito durante o sono, evite comer ou beber nas três (3) horas anteriores à utilização da máscara.
- Qualquer irritação cutânea anormal, desconforto estranho no peito, falta de ar, distensão gástrica, dor abdominal, eructação ou flatulência causada pelo ar ingerido, ou fortes dores de cabeça, durante ou logo após a utilização, deverá ser comunicada imediatamente a um profissional de saúde.
- A utilização da máscara pode causar dor de dentes, de gengivas ou dos maxilares ou agravar um problema dentário existente. Se sentir estes sintomas, consulte um médico ou um dentista.
- Consulte um médico se sentir algum dos seguintes sintomas enquanto está a utilizar a máscara: secura dos olhos, dor ocular, infecções oculares ou visão turva. Se os sintomas persistirem consulte um oftalmologista.
- Não aperte demasiado as correias do fixador. Vermelhidão, feridas ou pele inchada à volta das extremidades da máscara são alguns dos sinais de aperto excessivo. Solte um pouco as correias do acessório para a cabeça para aliviar os sintomas.
- Em pressões baixas de CPAP, o fluxo que passa pelas portas de expiração poderá ser inadequado para limpar todo o gás exalado dos tubos. Poderá ocorrer alguma reinaleração.
- Esta máscara deve ser utilizada com o dispositivo de pressão positiva nas vias respiratórias recomendado por um médico ou terapeuta respiratório. A máscara só deve ser utilizada quando o dispositivo de pressão

positiva nas vias respiratórias estiver ligado e a funcionar corretamente. Não bloqueie nem tente vedar a porta de expiração (orifícios de ventilação). Os orifícios de ventilação permitem um fluxo contínuo de ar para fora da máscara. Quando o dispositivo de pressão positiva nas vias respiratórias estiver ligado e a funcionar corretamente, o ar novo que provém do dispositivo expulsa o ar exalado através dos orifícios de ventilação. Quando o dispositivo de pressão positiva nas vias respiratórias não estiver a funcionar, o ar exalado pode ser reinalado. A reinalação de ar exalado pode provocar asfixia em algumas circunstâncias.

Esta advertência aplica-se à maioria dos modelos de aparelhos e máscaras CPAP.

- Esta máscara não se destina a pacientes sem impulso respiratório espontâneo. Esta máscara não deve ser utilizada em pacientes não cooperantes, atordoados, adormecidos ou sem capacidade para retirar a máscara. Esta máscara não é adequada a pessoas com os seguintes quadros clínicos: função do esfínter cardíaco debilitada, refluxo excessivo, refluxo da tosse debilitado e hérnia de hiato.
- Poderão ocorrer fugas significativas se a máscara não estiver bem colocada.
- Os ímanes são usados nos cliques da máscara e do arnês com uma intensidade de campo de 380mT. Com exceção dos dispositivos identificados na contra-indicação, certifique-se de que a máscara é mantida a pelo menos 6 polegadas (aproximadamente 16 cm) de distância de quaisquer outros implantes médicos ou dispositivos médicos que possam ser impactados pelos campos magnéticos para evitar possíveis efeitos dos campos magnéticos locais. Isto aplica-se a si ou a qualquer pessoa que tenha contacto físico próximo com a sua máscara.

## **INFORMAÇÕES GERAIS**

Elimine a máscara e respetivos acessórios de acordo com as diretrizes locais e regionais.

Esta máscara tem uma garantia limitada e não transferível de três meses para defeitos de fabrico a partir da data de compra pelo consumidor original (ou máximo de vida útil, se inferior). Se uma máscara utilizada em condições normais falhar, a Sleepnet substituirá a máscara. Para informações adicionais sobre a Garantia Sleepnet, visite <http://www.sleepnetmasks.com/>.

**NOTA:** a almofada da máscara tem uma vida útil de 1 mês. O conjunto de armação giratória/tubo tem uma vida útil de 3 meses. O acessório para a cabeça e ganchos magnéticos TruFit têm uma vida útil de 6 meses.

## **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

É recomendada a limpeza diária. Consulte as instruções de desmontagem. Lave a máscara e os componentes em água morna utilizando um sabão suave, como por exemplo Ivory®. Enxágue minuciosamente a máscara após a lavagem. Verifique visualmente se os orifícios de ventilação estão limpos e deixe a máscara secar ao ar. A lavagem do seu rosto antes de colocar a máscara removerá o excesso de oleosidade facial e ajudará a prolongar a vida útil da máscara.

**NOTA:** a almofada de gel, ainda que seja suave ao toque, não irá rasgar-se, verter ou separar-se da máscara em condições normais de utilização e seguindo os procedimentos recomendados para limpeza e manutenção. No entanto, a almofada de gel não é indestrutível. Se for sujeita a utilização ou manuseamento incorretos, poderá rasgar-se e sofrer cortes. Não lave na máquina de lavar loiça. A garantia não cobre este tipo de falhas do produto. Por isso, manuseie com cuidado a sua nova máscara nasal com ventilação **Phantom®2**.

**AVISO:** A frequência da limpeza, os métodos de limpeza ou a utilização de agentes de limpeza diferentes dos especificados acima, ou exceder a vida útil dos componentes podem ter um efeito adverso no dispositivo e, consequentemente, na segurança ou na qualidade da terapia.

## **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Intervalo de pressão terapêutica: 3 a 30 cm H<sub>2</sub>O

Resistência ao fluxo de ar a 50 L/min: 0,45 cm H<sub>2</sub>O

Resistência ao fluxo de ar a 100 L/min: 2,06 cm H<sub>2</sub>O

VOLUME DO ESPAÇO MORTO (ml aprox.): máscara – 30,7ml tubo – 68,3ml

Temperatura de funcionamento: não exponha a máscara a temperaturas superiores a 50 °C.

## **ANTES DA UTILIZAÇÃO**

- Inspecione a máscara diariamente ou antes de cada utilização. Substitua a máscara se os orifícios de ventilação estiverem bloqueados, se houver peças danificadas ou se o gel estiver exposto devido a cortes ou perfurações.

## **INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO DA PHANTOM®2**

1. Retire a máscara do saco. Ajuste a correia de base de acordo com o seu tamanho geral alinhando a alça pelas marcas de tamanho indicadas (S, M, L, XL). (Figura 1).
2. Destaque um gancho magnético da máscara. (Figura 2).
3. Após colocar a máscara na sua cabeça, volte a colocar o gancho magnético na posição original. (Figura 3).
4. Primeiro, ajuste a correia superior para levantar ou baixar a máscara. (Figura 4).

5. Depois, ajuste as correias esquerda/direita para se certificar de que a parte inferior da máscara se encontra confortavelmente entre a cana do nariz e mesmo acima do lábio superior. (Figura 5).
6. Una a máscara ao tubo do dispositivo de pressão nas vias respiratórias e ligue o dispositivo na pressão prescrita. Vire a cabeça para um lado e para o outro enquanto está deitado para garantir que a máscara está bem colocada. (Figura 6).
7. Se ocorrerem fugas, tente mover a máscara mais para cima ou mais para baixo em torno do nariz para encontrar o melhor ajuste. (Figura 7).
8. Pressione suavemente as extremidades da máscara para alterar a forma da máscara, criar um ajuste confortável e reduzir as fugas. (Figura 8).
9. Se as fugas persistirem, tente mover a máscara mais para cima ou mais para baixo em torno do nariz para encontrar o melhor ajuste. (Figura 9).

### **INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM**

1. Com uma mão, segure com firmeza a almofada da máscara num dos lados. (Figura 1).
2. Agarre num dos ímanes da armação giratória. (Figura 2).
3. Puxe com firmeza para separar a armação giratória da almofada como se estivesse a descascá-la. (Figura 3).

### **INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

1. Segure a estrutura giratória contra a máscara, ligeiramente inclinada para cima (Figura 1). Usando os dedos, apoie o anel de vedação da máscara por dentro.
2. Deslize a parte superior da estrutura giratória para dentro da máscara até que as hastes da máscara travem nas ranhuras da estrutura giratória (Figura 2).
3. Empurre suavemente a parte inferior da estrutura giratória para dentro da máscara até que a aba da estrutura giratória trave no lugar (Figura 3).
4. Inspecione visualmente o interior da máscara para garantir que o anel de vedação esteja devidamente encaixado na estrutura giratória (Figura 4).

**Phantom®2** é uma marca comercial da Sleepnet Corporation.

Visite o nosso website em [www.sleepnetmasks.com](http://www.sleepnetmasks.com).

## **Инструкция пользователя к назальной вентилируемой маске *Phantom®2***

**РУССКИЙ**



Назальная вентилируемая маска *Phantom®2* предназначена для использования с устройствами для поддержания положительного давления в дыхательных путях, такими как СИПАП или БИПАП, работающими при давлении 3 см водяного столба и выше. Маска может использоваться для взрослых пациентов (весом более 30 кг), которым назначено лечение методом создания положительного давления в дыхательных путях. Маска предназначена для многоразового применения одним пациентом дома, в больнице или в других учреждениях.

### **ПРИМЕЧАНИЯ**

- Настоящий продукт изготавливается без применения натурального каучукового латекса.
- При наличии у пациента **ЛЮБОЙ** реакции на любую часть конструкции маски прекратить ее использование.
- Канал для выдохания воздуха встроен в эту маску, поэтому применение отдельного соединения для выдохания не требуется.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Не используйте эту маску, если вы или какой-либо человек (например, члены семьи, партнеры по постели, лица, осуществляющие уход и т. д.), находящийся в тесном физическом контакте с вашей маской, имеет активный медицинский имплантат или металлический имплантат, который будет взаимодействовать с магнитами. Примеры имплантатов включают, помимо прочего, кардиостимуляторы, имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД), нейростимуляторы, зажимы для аневризмы, металлические стенты, глазные имплантаты, инсулиновые/инфузионные насосы, шунты для спинномозговой жидкости (СМЖ), спирали для эмболизации, металлические осколки, имплантаты для восстановления слуха или равновесия с помощью имплантированных магнитов (таких как кохлеарные имплантаты), устройства для нарушения потока, контактные линзы с металлом, зубные имплантаты, металлические черепные пластины, винты, заглушки для отверстий в черепе, устройства для замещения костной ткани, магнитные металлические имплантаты/электроды/клапаны, помещенные

в верхние конечности, туловище или выше, и т. д. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно имплантата, проконсультируйтесь со своим врачом или производителем вашего имплантата.

## **ВНИМАНИЕ**

- Федеральное законодательство США ограничивает продажу этого устройства, разрешая его продажу только врачами или по предписанию врача.
- Не подвергать назальную вентилируемую маску **Phantom®2** воздействию температур выше 50°C (122°F).
- Мaska предназначена исключительно для использования одним пациентом. Допускается очищение и повторное использование тем же человеком, но не допускается использование несколькими людьми. Не стерилизовать и не дезинфицировать.

## **ОСТОРОЖНО**

- Настоящая маска не пригодна для искусственной вентиляции легких в системах жизнеобеспечения.
- Назальную вентилируемую маску **Phantom®2** не следует использовать при исходном уровне давления менее 3 см водяного столба.
- При использовании кислорода вместе с маской для СИПАП-терапии необходимо прекращать подачу кислорода при выключении прибора СИПАП. Пояснения к тексту с заголовком «Осторожно»: Если не отключить подачу кислорода при выключенном приборе для СИПАП-терапии, то кислород, подаваемый по трубке устройства, может скапливаться в корпусе прибора для СИПАП-терапии. Скопление кислорода в корпусе прибора для СИПАП-терапии создает опасность пожара.
- При фиксированном расходе дополнительно подаваемого кислорода концентрация выдыхаемого кислорода будет варьироваться в зависимости от параметров давления, характера дыхания пациента, выбранной маски и расхода утечки.
- При подаче кислорода запрещается курение или использование открытого пламени, такого как свечи.
- Чтобы минимизировать риск рвоты во время сна, не следует есть и пить менее чем за три (3) часа до использования маски.
- Обо всех случаях необычного раздражения кожи, дискомфорта в грудной клетке, затрудненного дыхания, вздутия живота, болей в области живота, рвоты или метеоризма из-за проглатываемого воздуха, или сильной головной боли, испытываемой пациентом во время или непосредственно сразу после использования, следует немедленно сообщать медицинскому работнику.
- Применение маски может вызывать болезненные ощущения зубов, десен или челюстей или ухудшение существующих стоматологических заболеваний. При возникновении этих симптомов проконсультируйтесь с терапевтом или стоматологом.
- Проконсультируйтесь с терапевтом, если появляются любые из следующих симптомов при использовании маски: сухость в глазах, боль в глазах, глазные инфекции или размытое зрение. Если симптомы сохраняются, проконсультируйтесь с офтальмологом.
- Не перетягивайте ремни системы фиксации на голове. Признаки перетягивания включают: повышенное покраснение, синяки или набухание кожи у кромок маски. Ослабьте ремни системы фиксации на голове для облегчения симптомов.
- При низких значениях давления в СИПАП-приборе поток через каналы для выдохания может быть недостаточным для удаления всего выдыхаемого газа из трубы. Возможно частичное обратное вдыхание.
- Эту маску необходимо использовать с устройством для поддержания положительного давления в дыхательных путях, которое рекомендовано вашим врачом или респираторным терапевтом. Маску следует использовать только при включенном и исправно работающем устройстве для поддержания положительного давления в дыхательных путях. Не блокируйте и не пытайтесь закрыть канал для выдохания воздуха (вентиляционные отверстия). Вентиляционные отверстия обеспечивают постоянный поток воздуха из маски. Когда устройство для поддержания положительного давления в дыхательных путях включено и исправно работает, свежий воздух из устройства выталкивает выдыхаемый воздух через вентиляционные отверстия маски. Если устройство для поддержания положительного давления в дыхательных путях не работает, возможно повторное вдыхание выдыхаемого воздуха. Повторное вдыхание выдыхаемого воздуха может в некоторых случаях вызвать удушье. Это предупреждение относится к большинству приборов и масок для СИПАП-терапии.
- Эта маска не предназначена для использования пациентами без спонтанной активности дыхательного центра. Эта маска не должна использоваться неконтактными пациентами, пациентами с притупленной реакцией или без сознания, а также неспособными самостоятельно снять маску. Эта маска противопоказана для использования лицами со следующими

заболеваниями: нарушение функции кардиального сфинктера, повышенный рефлюкс, нарушенный кашлевый рефлекс и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

➤ Неправильная подгонка маски может вызвать значительную утечку воздуха.

➤ В маске и зажимах системы фиксации на голове используются магниты с напряженностью поля 380 мГл. За исключением устройств, указанных в противопоказаниях, убедитесь, что маска находится на расстоянии не менее 6 дюймов (около 16 см) от любых других медицинских имплантатов или медицинских устройств, которые могут подвергнуться воздействию магнитных полей, чтобы избежать возможного влияния локализованных магнитных полей. Это относится к вам и ко всем, кто находится в тесном физическом контакте с вашей маской.

## **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Утилизируйте маску и принадлежности в соответствии с местными и региональными правилами.

Эта маска имеет непередаваемую ограниченную гарантию на дефекты производства длительностью три месяца с даты покупки первоначальным потребителем (или максимальный срок службы, если он короче). Если маска, используемая в нормальных условиях, выйдет из строя, Sleepnet заменит маску. Для получения дополнительной информации о гарантии Sleepnet посетите, пожалуйста, сайт <http://www.sleepnetmasks.com/>.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Срок службы подушки маски составляет 1 месяц. Срок службы комплекта поворотного каркаса с трубками составляет 3 месяца. Срок службы системы фиксации на голове и магнитных зажимов TruFit составляет 6 месяцев.

## **САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА И УХОД**

Очищение рекомендуется проводить ежедневно. См. инструкции по разборке. Вымойте маску вместе с деталями в теплой воде с использованием мягкого моющего средства, такого как Ivory®. Тщательно прополосните маску после мытья. Визуально убедитесь, что вентиляционные отверстия чисты, и позвольте маске высокнуть на воздухе. Умывание вашего лица перед надеванием маски позволит удалить излишний кожный жир и продлить срок службы маски.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Хотя гелевая подушка шелковиста на ощупь, она не разорвется, не потечет и не отсоединится от маски при нормальному использовании и следовании рекомендованным протоколам очистки и обслуживания. Но и у гелевой подушки имеется предел прочности. Она подвержена износу, порезам и разрывам в случае неправильного или неосторожного использования. Не мыть в посудомоечной машине. Гарантия не распространяется на такие виды повреждений товара. Поэтому, пожалуйста, осторожно обращайтесь с вашей новой назальной вентилируемой маской **Phantom®2**.

**ОСТОРОЖНО!** Частота очистки, методы очистки или использование чистящих средств, отличных от указанных выше, или превышение срока службы компонентов могут отрицательно повлиять на устройство и, следовательно, на безопасность или качество терапии.

## **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Диапазон терапевтического давления: от 3 до 30 см водяного столба

Сопротивление потоку воздуха при расходе 50 л/мин.: 0,45 см водяного столба

Сопротивление потоку воздуха при расходе 100 л/мин.: 2,06 см водяного столба

МЕРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО (в мл, прибл.): Маска — 30,7 мл Трубка — 68,3 мл

Рабочая температура: Не подвергать маску воздействию температур выше 50°C (122°F).

## **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

➤ Выполните осмотр маски ежедневно или перед каждым использованием. Маска подлежит замене в случае перекрытия ее вентиляционных отверстий, повреждения ее деталей или выделения геля из-за разрывов или проколов.

## **ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОНКЕ МАСКИ PHANTOM®2**

1. Достаньте маску из пакета. Отрегулируйте базовый ремешок в соответствии с вашим общим размером, совместив язычок с указанными отметками размера (S, M, L, XL). (рис. 1).
2. Отсоедините один магнитный зажим от маски. (рис. 2).
3. Разместив маску на голове, прикрепите заново магнитный зажим. (рис. 3).
4. Сначала отрегулируйте верхний ремешок, чтобы поднять или опустить маску. (рис. 4).
5. После этого отрегулируйте левый и правый ремешок так, чтобы нижняя часть маски плотно и удобно прилегала к переносице и зоне чуть выше верхней губы. (рис. 5).
6. Подсоедините маску к трубке устройства для поддержания положительного давления в дыхательных путях и включите устройство для создания предписанного значения давления. Лежа на кровати, поворачивайте голову из стороны в сторону, чтобы убедиться в надежности подгонки. (рис. 6).

7. Если возникают нежелательные утечки, попробуйте переместить маску выше или ниже вокруг носа, чтобы найти оптимальную посадку. (рис. 7).
8. Аккуратно нажмите на края маски, чтобы изменить форму маски, обеспечить удобную посадку и уменьшить утечки. (рис. 8).
9. Если утечки сохраняются, попробуйте переместить маску выше или ниже вокруг носа, чтобы найти оптимальную посадку. (рис. 9).

### **ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗБОРКЕ**

1. Крепко держивайте подушку маски с одной стороны одной рукой. (рис. 1).
2. Возьмитесь за поворотный каркас с помощью одного из магнитов. (рис. 2).
3. Сильно потяните, чтобы отделить поворотный каркас от подушки отслаивающим движением. (рис. 3).

### **ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ**

1. Прижмите поворотный каркас к маске, слегка наклонив ее вверх (рис. 1). Пальцами поддерживайте уплотнительное кольцо маски изнутри.
2. Вдвигайте верхнюю часть поворотного каркаса в маску до тех пор, пока стойки маски не зафиксируются в пазах поворотного каркаса (рис. 2).
3. Аккуратно вставьте нижнюю часть поворотного каркаса в маску, пока выступ поворотного каркаса не зафиксируется на своем месте (рис. 3).
4. Осмотрите маску изнутри и убедитесь, что уплотнительное кольцо правильно установлено на поворотном каркасе (рис. 4).

**Phantom®2** является торговой маркой корпорации Sleepnet.

Посетите наш веб-сайт: [www.sleepnetmasks.com](http://www.sleepnetmasks.com).

## **Phantom®2 開孔口付き鼻マスクの使用説明書**

日本語

**⚠** **Phantom®2開孔口付き鼻マスク**は、気道陽圧装置（例えば、3 cm H<sub>2</sub>Oまたはそれ以上で操作するCPAPまたは双レベル）で使用されることを目的としています。このマスクは気道陽圧治療が処方された成人の患者（>30kg）に用いられます。このマスクは、1人の患者が自宅や病院などの環境で複数回使用することを目的としています。

### **注意**

- この製品には天然ゴムラテックスは使われていません。
- マスクの構造の一部に患者が何らかの反応をした場合、使用をやめてください。
- 呼気ポートはこのマスクに内蔵されているため、別の呼気ポートは必要ありません。

### **禁忌**

あなたや、マスクと物理的に密接になる人（例：家族、あなたの隣で寝る人、介護者など）が、磁石と相互作用する医療用インプラントや金属製インプラントを現在装着している場合は、このマスクを使用しないでください。インプラントの例には、ペースメーラー、植込み型除細動器（ICD）、神経刺激装置、動脈瘤クリップ、金属ステント、眼科インプラント、インスリン/注入ポンプ、脳脊髄液（CSF）シャント、塞栓コイル、金属破片、聴覚や平衡感覚を回復するための磁石が埋め込まれたインプラント（人工内耳など）、流れ破壊装置、金属付きコンタクトレンズ、歯科用インプラント、金属製頭蓋プレート、ネジ、バーホールカバー、骨代替装置、上肢、胴体、その上部に埋め込まれた磁性金属インプラント/電極/バルブも含まれますが、これには限られません。インプラントに関してご質問がある場合は、医師またはインプラントの製造元にご相談ください。

### **注意事項**

- 米国連邦法は、本製品の販売を医師、或いは医師の指示のみに限定しています。
- 122°F (50°C) 以上の温度に **Phantom®2 開孔口付き鼻マスク**をさらさないでください。
- このマスクは患者1人が使用することを想定しています。このマスクは、同じ人が何度も洗浄して繰り返し使用することができますが、決して複数の人で共有しないでください。殺菌や消毒はしないでください。

### **警告**

- このマスクは、生命維持装置には使用できません。
- **Phantom®2 開孔口付き鼻マスク**を3 cmH<sub>2</sub>O未満の基準圧で使用しないでください。
- 酸素をこのCPAPマスクとともに使用する場合、CPAP装置が作動していないときは、酸素の流入はオフにする必要があります。警告の説明：CPAP装置が作動していないときに酸素を流入したままにすると、換気装置に送り込まれる酸素がCPAP装置内に貯まる場合があります。CPAP装置内に酸素が貯まると火災の原因になる可能性があります。

- 固定された補足酸素流量では、圧力設定、患者の呼吸パターン、マスクの選択、漏れ率に応じて、吸入される酸素濃度は異なります。
- 酸素を使用しているときは、喫煙やろうそくなど、火気を使用しないでください。
- 睡眠中の嘔吐のリスクを最小限に抑えるために、マスクを使用する3時間前は飲食を控えてください。
- いつもとは異なる皮膚の炎症があつたり、胸部に不快感、息切れ、胃膨張、腹痛、げっぷ、吸入空気の鼓腸、または、使用中や直後に患者がひどい頭痛を訴える場合は、医療専門家にすぐに報告する必要があります。
- マスクを使用することで、歯、歯茎、あご痛みを引き起こす場合や、歯の現状態が悪化する場合があります。症状がある場合は、医師または歯科医に相談してください。
- マスクを使用中に、次のような症状が現れた場合には、医師に相談してください。目の乾燥、目の痛み、目の感染、かすみ目。症状が続く場合は、眼科医に相談してください。
- 頭部のストラップをきつく締めすぎないでください。マスクの端があたる部分に過度の赤み、痛み、腫れがあるときは、きつく締めすぎているしです。頭部のストラップを緩めると症状が緩和します。
- 低圧のCPAPで呼気ポートを通る流量では、配管からすべての排出ガスを十分に排出できない可能性があります。再呼吸が起こる可能性があります。
- このマスクを、医師や呼吸療法士が推奨する気道陽圧装置で使用してください。気道陽圧装置の電源が入り、適切に動いていない限り、マスクを使用しないでください。呼気ポート（通気口）を塞いだり密封したりしようとしないでください。開孔口によって、マスクの外に絶えず空気を排出できます。気道陽圧装置の電源を入れて、装置が適切に機能していると、装置から送り込まれる新しい空気がマスクの開孔口から排出されます。気道陽圧装置が動いていないときは、呼気を再び吸ってしまうことがあります。呼気を再び吸うと、場合によっては、窒息を引き起こすことがあります。この警告はCPAP装置とマスクのほとんどどのモデルに適用されます。
- このマスクは、自発呼吸をしない患者を対象としたものではありません。このマスクは、非協力的な人や、感覚が鈍麻している人、無反応やマスクを自分で外すことができない患者には使用できません。このマスクは、以下の状況の人には適していない場合があります。  
心臓括筋機能に障害がある人、過度の逆流症や咳反射に障害がある人、裂孔ヘルニアがある人。
- マスクを適切に付けないと、酸素が大量に漏れる場合があります。
- マスクとヘッドギアのクリップには、磁界強度 380mT の磁石が使用されています。禁忌事項で特定されている機器を除き、局在磁場の影響を受ける可能性があるため、磁場に影響を受ける他の医療インプラントや医療機器から、マスクを少なくとも 6 インチ (約 16 cm) 離してください。これは、あなたご自身、またはマスクに近くにいたり、物理的に接触する人に適用されます。

## 一般情報

地域のガイドラインに従ってマスクと付属品を廃棄してください。

このマスクには、製造側に原因がある場合、最初の購入者の購入日から3カ月間（最長使用期限の方が短い場合は最長使用期限を優先）の保証が付いており、この保証は譲渡できません。マスクを通常の使用条件で使用して不具合が生じた場合は、Sleepnetがマスクを交換します。Sleepnetの保証の詳細については、<http://www.sleepnetmasks.com/>をご覧ください。

**注：**マスククリッショングの使用期限は1カ月間です。回リフレーム/チューブセットの使用期限は3カ月間です。TruFit ヘッドギアおよびマグネットクリップの使用期限は6カ月間です。

## 洗浄と保守

毎日洗浄することが推奨されます。分解の手順を参照してください。Ivory®のような低刺激の石鹼を用いてマスクや構成品を温水で洗います。洗浄後はマスクよくすすぎます。通気口が清潔になったことを目で確認し、マスクを空気乾燥させます。マスクをつける前に顔を洗い、余分な皮脂を洗い流すと、マスクが長持ちします。

**注：**ジェル・クリッショングは、手触りは柔らかく滑らかですが、通常の使用で、推奨された洗浄や保守の方法に従えば、裂傷、漏洩したり、マスクから外れることはできません。しかし、ジェル・クリッショングは絶対に壊れない、というわけではありません。使用方法を誤ったり、粗末に扱うと、裂けたり切れたりします。食器洗浄機で洗わないでください。これらの種類の製品の不良については保証が適用されません。そのため、新しいPhantom®2開孔口付き鼻マスクの取り扱いには気を付けてください。

**ご注意ください：**上記の指定以外の洗浄頻度、洗浄方法、洗浄剤の使用、または構成部品の耐用年数を超えると、デバイスに悪影響が及び、その結果、安全性や治療の質に悪影響が及ぶ可能性があります。

治療圧力範囲：3～30 cm H<sub>2</sub>O

50L/分の気流に対する抵抗：0.45 cm H<sub>2</sub>O

100L/分の気流に対する抵抗：2.06 cm H<sub>2</sub>O

死腔量（mL 近似値）：マスク - 30.7ml Tube - 68.3ml

動作温度：122°F (50°C) 以上の温度にマスクをさらさないでください。

### 使用前

毎回使用する前にマスクを検査してください。開孔口が塞がれている場合、部品に損傷がある場合、裂傷や穴があいておりジェルが露出している場合は、マスクを交換してください。

### Phantom®2 取扱の説明

1. マスクを袋から出します。サイズ(S、M、L、XL)のマークの表示位置にタブを合わせて、ご自身のサイズにベースストラップを調節します(図1)。
2. マスクからマグネットクリップを1つ外します(図2)。
3. マスクを頭部に取り付けたら、外したマグネットクリップを再び取り付けます(図3)。
4. まず、マスクを上げたり下げたりして上のストラップを調節します(図4)。
5. 次に、マスクの下部が鼻梁と上唇のすぐ上の間で楽に密閉されるように左/右のストラップを調節します(図5)。
6. マスクを気道陽圧装置のチューブに接続し、装置の電源を入れて規定の圧力に設定します。ベッドに横になり、頭を左右に振ってしっかりと取り付けられていることを確認します(図6)。
7. 許容程度以上の漏れが生じたら、マスクを鼻の周りで上や下に動かしてちょうどよくフィットする場所を探します(図7)。
8. マスクの端を優しく押してマスクの形を変え、心地よくフィットさせ、漏れを軽減します。(図8)。
9. 漏れが続く場合は、マスクを鼻の周りで上や下に動かしてちょうどよくフィットする場所を探します(図9)。

### 分解の説明

1. マスククッションの片側を片手でしっかりと持ちます(図1)。
2. マグネットの1つで回りフレームを掴みます(図2)。
3. 回りフレームを引っ張ってクッションから剥がすように離します(図3)。

### 組立の説明

1. シイベルフレームをやや上に傾けた状態でマスクに当てます(図1)。指を使ってマスクのシールリングを内側から支えます。
2. マスクの突起がシイベルフレームの溝にはまるまで、シイベルフレームの上部をマスクに差し込みます(図2)。
3. シイベルフレームのタブが所定の位置にはまるまで、シイベルフレームの下部を軽くマスクに押し込みます(図3)。
4. マスクの内側を目視で確認し、シールリングがシイベルフレームに正しく装着されているか確認します(図4)。

Phantom®2 はSleepnet Corporationの商標です。

[www.sleepnetmasks.com](http://www.sleepnetmasks.com)にアクセスしてください。

## قناع Phantom®2 الأنفي بفتحات تنفس إرشادات المستخدم

العربية

قناع Phantom®2 الأنفي بفتحات التنفس هو قناع مخصص للاستخدام مع أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي، مثل أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المترافق (CPAP) أو ثانية المسنوي التي تعمل عند 3 سنتيمتر من الماء أو أعلى. القناع مخصص للاستخدام بواسطة المرضى البالغين (أعلى من 30 كجم) الذين تم تصميمه للاستخدام بضغط المجرى الهوائي الإيجابي لهم. القناع مخصص لمريض واحد، بغرض الاستخدام المتعدد في المنزل أو المستشفى أو البيئة المؤسسة.



### ملاحظة

- » هذا المنتج غير مصنوع باستخدام اللاتكس المطاطي الطبيعي.
- » إذا ظهر لدى المريض أي رد فعل تجاه أي قطعة في نظام القناع، فيجب التوقف عن استخدامه.
- » يوجد منفذ للزفير بهذا القناع لذا لا توجد حاجة لمنفذ زفير منفصل.

### موانع الاستخدام

لا تستخدم هذا القناع إذا كنت أو أي شخص (على سبيل المثال: أفراد الأسرة، وشركاء الفراش، و يقدمون الرعاية، وما إلى ذلك) يلامس قناعك جسدياً عن قرب ولديه غرسة طبية نشطة أو غرسة معدنية ستفتصل مع المغناطيس. تشمل أمثلة الغرسات، على سبيل المثال لا الحصر، أجهزة تقطيل ضربات القلب، وأجهزة إزالة الرجفان الطبلية الفايطة للزرع (ICD)، والمحفزات العصبية، ومشابك تعدد الأوعية الدموية، والدعامات المعدنية، وغرسات العين، وممضخات الأنسولين/التسيب، وتحويلات السائل الشوكي الدماغي (CSF)، والملفات الصمية، والشظايا

المعدنية، والغرسات المخصصة لاستعادة السمع أو التوازن باستخراج المغناطيسات المزروعة (مثل زراعة القوقة)، وأجهزة تعطيل التتفق، والعدسات اللاصقة المعدنية، وغرسات الأسنان، وألواح الجمجمة المعدنية، والمسامير، وأغطية فتحات المتقب، وجهاز بديل للعظم، والغرسات المعدنية المغناطيسية/الأقطاب الكهربائية/السمامات الموضوعة في الأطراف العلوية أو الجذع أو أعلى، وما إلى ذلك. إذا كانت لديك أي أسلطة بخصوص الغرس، فاستشر طبيبك أو الشركة المصنعة للفرسة الخاصة بك.

### تتبّع

» لا يسمح القانون الفيدرالي الأمريكي ببيع هذا الجهاز إلا بواسطة الطبيب أو بأمر منه.

» لا تعرض قناع Phantom® الأنفي بفتحات التفقيس لدرجات حرارة أعلى من 122 فهرنهايت (50 مئوية).

» القناع مخصص لاستخدام مريض واحد فقط. يمكن تنظيفه وإعادة استخدامه مع نفس الشخص ولكن يجب أن لا يتم استخدامه مع أشخاص متعددين. لا تقم بتطهيره أو تعقيمك.

### تحذيرات

» هذا القناع غير مناسب لتوفير الهواء اللازم لإيقاف الحياة.

» لا تستخدم قناع Phantom® الأنفي بفتحات التفقيس مع ضغط خط أسماس أقل من 3 سنتيمتر من الماء.

» في حالة استخدام الأكسجين مع قناع CPAP هذا، يجب إيقاف تشغيل تدفق الأكسجين أثناء توقف ماكينة CPAP عن العمل. شرح التحذير: أثناء توقف جهاز CPAP عن العمل، واستمرار تدفق الأكسجين، قد يتراكم الأكسجين الذي يدخل في جهاز التهوية داخل حبيرة ماكينة CPAP. الأكسجين المتجمع في حبيرة ماكينة CPAP قد يؤدي للحرق.

» عند الوصول لمعدل تدفق ثابت للأكسجين المستنشق، سيختلف تركيز الأكسجين المستنشق، تبعاً لإعدادات الضغط وتفس المريض و اختيار القناع ومعدل التسرب.

» منع التدخين أو استخدام مصادر اللهب المكشوفة مثل الشموع عند استخدام الأكسجين.

» لقليل خطر التقى إلى أدنى حد أثناء النوم، تجنب تناول الطعام أو الشراب قبل استخدام القناع بثلاث ساعات على الأقل.

» في حالة حدوث أي تهيج غير معتاد في الجلد، أو ضيق في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو انتفاخ في المعدة، أو الم في البطن، تجنبه أو انتفاخ بسبب الهواء الذي تم ابتلاعه، أو صداع حاد يتعرض له المريض أثناء الاستخدام أو بعد مبشرة يجب إبلاغ أخصائي الرعاية الصحية عنه على الفور.

» قد يؤدي استخدام القناع إلى وجع في الأسنان أو اللثة أو الفك أو يؤدي إلى تفاقم مشكلة موجودة في الأسنان بالفعل. إذا حدثت مثل هذه الاعراض، فاستشر طبيب أو طبيب أسنان.

» استشر طبيب عيون إذا استمرت الأعراض.

» لا تربط شرائط قناع الرأس بشكل مفرط. تتضمن علامات الرابط المفرط: إحمرار شديد، أو وجع، أو بروز الجلد حول حوار القناع. قم بإرخاء شرائط قناع الرأس قليلاً لتخفيض حدة الأعراض.

» في حالات الضغط الهوائي الإيجابي المتواصل (CPAP) المنخفض، قد يكون التدفق عبر منافذ الزفير غير كافٍ لإزالة كل الغاز المزفر من الأنفون. قد تتم إعادة التنفس بعض الشيء.

» يجب استخدام هذا القناع مع جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي الموصى به من قبل طبيبك، أو أخصائي علاج الجهاز التنفسي. يجب إلا يتم استخدام القناع مالم يتم تشغيل جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي وعمله بشكل صحيح. لا تنس أو تحاول إغلاق منفذ للزفير (فتحات التفقيس). تسمح فتحات التفقيس بالتنفس المستمر للهواء خارج القناع. حينما يتم تشغيل جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي وعمله بشكل صحيح، يدفع الهواء الجديد خارج من الجهاز الهوائي المزفر خارج فتحات تفقيس القناع. حينما لا يعمل جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي، قد تتم إعادة تنفس الهواء المزفر. إعادة تنفس الهواء المزفر، قد تؤدي في بعض الحالات، إلى الاختناق. ينطبق هذا التحذير على أعلى الطرازات الخاصة بـماكينات وأنواع CPAP.

» هذا القناع غير مخصص للمرضى من لا يوجد لديهم مشكلة تنفسية عفوية. يجب إلا يتم استخدام هذا القناع مع المرضى غير المتعاونين أو متبدلي الإحساس أو غير المستجيبين أو غير القادرين على نزع القناع. قد لا يكون هذا القناع مناسباً للاشخاص الذين يعانون من الحالات التالية: اختلال وظيفة العضلة العاصرة للقلب، الارتداد المفرط، ضعف في السعال الانتعاسي، فتق الحجاب الحاجز.

» قد يحدث سرب شديد إذا لم يتم وضع القناع بشكل صحيح.

» يتم استخدام المغناطيسات في مشابك القناع وطقم الرأس بقوّة مجال تبلغ 380 مليتسلا. باستثناء الأجهزة المحددة في موانع الاستعمال، تأكّد من إبقاء القناع على بعد 6 بوصات (حوالي 16 سم) على الأقل بعيداً عن أي غرسات طبية أو أجهزة طبية أخرى يمكن أن تتأثّر بالحالات المغناطيسية لتجنب التأثيرات المحتملة من المجالات المغناطيسية الموضعية. ينطبق هذا عليك أو على أي شخص يلامس قناعك جسدياً عن قرب.

### معلومات عامة

تخلص من القناع والملحقات تبعاً للإرشادات المحلية والإقليمية.

هناك ضمان محدود لهذا القناع تبلغ منه ثلاثة أشهر غير قابل للنقد ضد عيوب المصنع بداية من تاريخ شراء أول مستخدم للمنتج (أو أقصى مدة لاستخدام القناع، إذا كانت أقصر). في حالة عدم عمل القناع تحت الظروف العاديّة، ستنسّب Sleepnet مزيد من المعلومات حول ضمان Sleepnet، يرجي زيارة <http://www.sleepnetmasks.com>.

**ملاحظة:** يمكن استخدام وسادة القناع لمدة شهر واحد. يمكن استخدام إطار الوصلة المترابحة/مجموعة الأدايب لمدة 3 شهور. يمكن استخدام طقم رأس TruFit والمشابك المغناطيسية لمدة 6 شهور.

### التنظيف والصيانة

يوصى بالتنظيف يومياً. راجع إرشادات الـ إيهـ دـافـيـهـ. أغسل القناع ومكوناته في ماء دافئ باستخدام مادة منظفة لطيفة مثل Ivory®. اشطف القناع جيداً بعد الغسل. تأكّد بعينك أن فتحات التفقيس غير مسدودة وتسمح للقناع بأن يجف في الهواء. غسل وجهك قبل تركيب القناع سبزيل زيوت الوجه الزاندة ويساعد على إطالة حياة القناع.

**ملاحظة:** الوسادة الجل، على الرغم من ملمسها الناعم، لن تتنزق أو تسرق أو تفصل عن القاع عند استخدامها بشكل طبيعي واتباع بروتوكولات التنظيف والصيانة الموصى بها. ومع ذلك، الوسادة الجل ليست مقاومة للتلذ. سوف تتنزق وتقطع وتشقق عند إساءة استعمالها.

لا تتنفس المنتج في غسالة الصحون. لا يشمل الضمان عدم عمل المنتج في هذه الحالات. لذا تعامل مع قاع **phantom® الأنفي** بفتحات التفريغ الجديد لديك بحرص.

**تحذير:** قد يكون لوتيرة التنظيف، وطرق التنظيف أو استخدام مواد تنظيف، بخلاف تلك المحددة أعلاه، أو تتجاوز مدة استخدام المكونات تأثيراً عكسيّاً على الجهاز وبالتالي على أمان أو جودة العلاج.

المعلومات الفنية

**نطاق الضغط العلاجي:** 3 إلى 30 سنتيمتر من الماء مقاومة لتدفق الهواء عند 50 لتر/ دقيقة: 0.45 سنتيمتر من الماء مقاومة لتدفق الهواء عند 100 لتر/ دقيقة: 2.06 سنتيمتر من الماء حجم المجال الممتنع (تقريرياً): القناة - أنواع 30.7 مل - 68.3 مل حرارة التشغيل: لا ترتفع القناة لدرجات حرارة أعلى من 122 فهرنهايت (50 مئوية).

قبل الاستخدام

► أفحص القالع يومياً قبل كل استخدام، استبدل القالع إذا كانت فتحات التفقيس مسدودة، أو إذا كانت هناك أجزاء تالفه به، أو إذا كان الجل مكشوف نتنة لتم قات أو ثقوب.

**ارشادات تجمیع PHANTOM® 2**

١. آخر الفناء من الحقيقة. اضبط الشريط القاعدي تبعاً لحجمك العام بمحاذة العروة تبعاً لعلامات الحجم الظاهرة (صغير، متوسط، كبير، كبير للغاية). (الشكل ١).
  ٢. أفصل مشبك مغناطيسي واحد من الفناء. (الشكل ٢).
  ٣. بعد وضع الفناء على رأسك، قم بتصويب المشبك المغناطيسي من جديد. (الشكل ٣).
  ٤. أولًا، اضبط الشريط العلوي لرفع الفناء أو تنزيله. (الشكل ٤).
  ٥. ثانيةً، اضبط الشريطين الأيسر/الأيمن للتأكد من أن الجزء السفلي من الفناء منطبق على وجهك بشكل مريح ما بين جسر الأنف وأعلى الشفة العليا مباشرةً. (الشكل ٥).
  ٦. قم بتصويب الفناء بأنياب جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي وقم بتشغيل الجهاز وفقًا للضغط الموصى به. اندر رأسك من جنب آخر بينما ترتفع على السرير للتأكد من سأقراطه جيدًا. (الشكل ٦).
  ٧. إذا حدث ترسيرات على السرير، فحاول تحريك الفناء لأعلى أو لأسفل حول الأنف كي ينطوي على وجهك على أفضل نحو. (الشكل ٧).
  ٨. اضغط برفق على الفناء لتغيير شكله، وضمان اطباقه بشكل جيد على الوجه، وتقليل الترسيرات. (الشكل ٨).
  ٩. إذا أستمرت الترسيرات، فحاول تحريك الفناء لأعلى، أو لأسفل حول الأنف كي ينطوي، على وجهك على، أفضل نحو. (الشكل ٩).

١، شادات الفك

1. امسك وسادة القاع بقوه بيده واحده جاذبها الي جانب واحد. (الشكل 1).
  2. امسك إطار الوصلة المترابطة باستخدام قفلة من قطع المغناطيسي. (الشكل 2).
  3. اسحب قفلة لفصل الوصلة المفترضة واحدة من الوسادة حرارة شبيه بالتشhir. (الشكل 3).

الشادات التحمسية

1. ارفع إطار الوصلة المترابحة بحيث يكون أمام القناع، مع تثبيته أعلى قليلاً (الشكل 1). باستخدام أصابعك، اسند حلقة السد الموجودة بالقانع من الداخل.
  2. قم بـبابلنة الجزء العلوي من إطار الوصلة المترابحة في القانع إلى أن تستقر حمّالات القناع بشكل ممكح في حزوب الإطار (الشكل 2).
  3. ادفع الجزء السفلي من إطار الوصلة المترابحة في القانع إلى أن تستقر عرفة الوصلة المترابحة بشكل ممكح في مكانها (الشكل 3).
  4. افحص القناع من الداخل بعينيك التلذك من أن حلقة السد مستقرة بشكل صحيح داخل إطار الوصلة المترابحة (الشكل 4).

.Sleepnet Corporation هو علامة تجارية لـ **Phantom®2**

قم بزيارة موقع الانترنت على [www.sleepnetmasks.com](http://www.sleepnetmasks.com)

הווראות לשימוש ב-<sup>®</sup>*Phantom* - מסכת אפ' בעלת חורי אוזורו

ערבית

**phantom<sup>2</sup>** - מסכת אף בעלת חורי אוורור מיועד לשימוש במשולב עם מכשירים לצירוף לחץ חיובי בדרכי הנשימה, למשל מכשירי סיפאפ או ביפאפ, בלבד של 3 ס"מ מים ומעלה. המסכה מיועדת לשימוש מתופלים בגירום (30 >ק") שנושם להם טיפול באטען לחץ חיובי בדרכי הנשימה. המסכה מיועדת לשימוש רב-פטיימי על ידי לטופול בלבד בכיסי ביתן הגולמים או במוסך פגאי או טיפול.

הערות

המודרך לא מיזכר עם גומי טבעי (לטקס).

אם מתכוורת אל המטופול מוגנה כלשויו לחלק חסומים מערכת המסנהה, יש להפסיק את השימוש.  
המסנהה כוללת יציאת נשיפה מובנית, כך שאין צורך ביציאת נשיפה פרדרת.

המסנה כוללת יציאת נשיפה מובנית, אך שאין צורך ביציאת נשיפה נפרדת.



## גמוניות נגדי

אל תשתחם במסכה זו אם לך או לכל אדם אחר (לדוגמה: בני בית, שותפים לימיთה, מטפלים וכו') שהויה ברגע פפי הדוק עם המסכה שלך יש שטל רפואי פעיל או שטל מתכתי שיוציאו אינטראקציה עם מגנטים. דוגמאות לשלטים כולות, בין היתר, קוצבי לב, דיפריביליטורים מושתלים (CD), נירוסטימלטוריים, טפסי מפרצת, טנטיטים מהכתמיים, שתלי עיניים, משאבות אינסולין/איינזוזה, שאנטיים של גולן נגד השדרה (CSF), סיליליטים סחכי פיזיים, ריסטי חתכת, שלטים לשיקום השמיעה או האיזון באמצעות מגנטים מושתלים (כגון שלטים שבולליים), התקני הפעעה ברזימה, עדשות מגע עם מתכת, שלטים דנטליים,لوحות גולגולת מתכתיים,ברגים, כיסויי חורים, מכשיר תחלפי עצם, שלטים מתכתיים/אלקטרוודות/שסתומים מגנטיים המומוקמים בגופים העליונים, בפלג גופ העליון או במיקום גבוה יותר. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לשטל, התיעץ עם הרופא שלך או עם יצרן השטל.

## זהירות

החוק הפלדורי באלה<sup>2</sup> מביר את מכירת המכשיר הזה להרופא בלבד או בהוראת רופא בלבד. אין לחשוף את **Phantom<sup>®</sup>** - מסכת אף בעלת חורי אוורור לטמפרטורת מעל (50°C / 122°F). המסכה מיועדת לשימוש מוגבל בלבד בלבד. ניתן לנ��ות אותה ולהשתמש בה שוב ושוב על אותו אדם, אולם אין להעבירה אותה לאדם נוסף. אין לעקר או לחטא.

## אזהרות

המסכה לא מתאימה לביצוע הנשמה מצילת מ-2<sup>®</sup> - מסכת אף בעלת חורי אוורור כאשר לחץ נקודת ההתחלה קטן מ-3 ס"מ מים. אם נעשה שימוש בחמצן במקביל למסכת סיפאפ זו, יש ללבוט את זרימת החמצן בזמן שימוש הסיפאף לא פועל. הסבר אודות האזהרה: כאשר מכשיר הסיפאף לא פועל, וזרימת החמצן נשכחת, החמצן שMOVVER לתוכן צינורות מכונת הנשמה עולה להאטטרבר בתוך החלל הסגור של מכונת הסיפאף. החמצן שמצוטר בתוך חל מוכנות הסיפאף ייגרם לסכנת שריפה.

כאשר נעשה שימוש בתוספת חמצן המורם בקצב קבוע, ריכוז החמצן הנשאף ישתנה בהתאם להגדירות הלחץ, דפוס הנשימה של המטופל המסכה שנברחה וקצב הדילופה. אין לעשן או להשתמש בהבה חשופה, כגון נרוץ, בעת שנעשה שימוש בחמצן. כדי למזער את הסיכון להקהה בזמן השינה, יש להימנע מואכל ושתייה במשך שלוש (3) שעות טרם השימוש במסכה.

יש לדוח מיד לאיש צוות רפואי אם למטופל יש גירוי חריג בעור, אי-נוחות בחזה, קוצר נשימה, התרחבות של הקיבה, כאב בטן, גהוקים או גזים בطن מהאויר הנשאף, או אם נגרם לו כאב ראש חמוץ במהלך השימוש או מזיד לאחר מכך.

השימוש במסכה עלול לגרום לנכדים בשניים, בחניכים או בלסט או להחמיר בעיה דנטלית קיימת. אם מופיעים תסמיינים, יש להיוועץ ברופא או ברופא שניים. היועץ ברופא אם אחד או יותר מהתסמיינים הבאים מתרחשים בזמן השימוש במסכה: יושב בעיניים, כאבי עיניים, זיהומים בעיניים או ראייה מושפעת. סימני הדיקט יתר נולדים: אדמומין יתר, פצעים או בליטות אין להדק את רצשות הראש יתר על המידה. יש שחרר את רצשות הראש כדי לנקל את התסמיינים. בעור סיפאפ נזקים, הרוימה דרך יציאת הנשימה עלולה להיות חלה מכך לפונות את כל הגזים.

יש לשתחם במסכה זו במושולב עם מכשיר ליצירתי לחץ חובי בדרכי הנשימה לפי המלצת הרופא או המטופל השימית. אין לשתחם במסכה זו אלא אם המכשיר שואור לחץ חובי בדרכי הנשימה دولק ופועל כיואת. אין לסתום או לנסתות לאטום את יציאת הנשימה. חורי האוורור מאפרשי זרים מוגבלים רציפה אל לחץ במסכה. כאשר המכשיר שיוצר לחץ חובי בדררכי הנשימה دولק ופועל וכיואת, אויר חדש מהמכשיר מפנה את האויר הנשאף החוצה דרך האוורור של המסכה. כאשר המכשיר שיוצר לחץ חובי בדררכי הנשימה לא פועל, ניתן שהמטופל יושם בשנית את האויר הנשאף. נשימה חזרה של אויר שנשף עלולה לגרום מתקנים. אזהרה זו חלה על רוב דגמי מכונות ומיכנות הסיפאף.

מסכה זו לא מיועדת למטופלים שלא דוחך נשימתו עצמוני. אין לשתחם במסכה זו במטופלים שלא משתמשים עלולה, שפוגנים קחות חושים, שלא מגיבים או שלא מסוגלים להוריד את המסכה. ניתן במסכה זו לאנשים שסובלים מהמצבים הרפואיים הבאים: תפוקוד לקוי של סוגר (ספיקטור) הלב, החור ו/or מהקייבר, רפלקס שיעול לקוי ובכע סרעפני.

הנתה המסכה על הפהים בצוואר לא נזונה עלולה לגרום לדילופה משמעותית. מגנטים נמצאים בשימוש בתופsie המסכה וכיסויו הראש עם חזק שדה של 380mT. כמעט המכנים המצויים בתהווית הנגד, ודואו שהמסכה נשמרת ברוחק של לפחות 16 ס"מ בקירוב (6 אינץ') מכל שטח רפואי או מכשיר רפואי אחר שעלול להיות מושפע מהשדות המגנטיים, וזאת כדי למנוע השפעות אפשריות משדות מגנטיים מוקמים. הדבר על ערך או על כל אדם שנמצא ברגע פיזי הדוק עם המסכה של.

## תיעוד כלילי

יש להשליק את המסכה והאביזרים לפי ההנחיות המקומיות והאזוריות.

המסכה בעלת אחריות מוגבלת שנשכחת שלושה חודשים ולא ניתן להעbara. האחוריות חלה על פגמי יצור ותקפה מתאריך הרכישה על ידי הלוקו הרפואי הראשון (או משך חייו הרווחים המרביים, אם מדובר בתקופה קצרה יותר).

אם ייעשה שימוש במסכה בתנאי שימוש רגילים ותיה בעיה או תקלה בתפקודה, Sleepnet, יש>bker באטר בכתובת סל Sleepnet Masks.com/.  
<http://www.sleepnetmasks.com/>

**הערה:** משך חי השירות של כרית המסכה הוא חדש אחד. משך חי מסגרת הסביבול/ערכת הצינור הוא 3 חודשים. משך חי השירות של יחידת רציפות הראש TruFit והטפסים המגנטיים הוא 6 חודשים.

### **ניקוי ותחזוקה**

ומולץ לנוקות על בסיס יומי. עיין בהוראות הפירוק. רוחץ את המסכה ורכיביה במים חמימים וסובן עדין, למשל Ivory®. שטוף את המסכה ריטב לאחר הרחיצה. בחרן את חורי האוורור כדי לוודא שהם ריקים ונוחם למסכה להתייבש באוויר. רוחצת הפנים טרם הנחת המסכה תסיר שמןנות יתר מהפנים ותעזר להאריך את חי המסכה.

**הערה:** כרית הג'ל אמן רכה למגע כמו משי, אולם היא לא תקרע, מдолפ או מתנתק מהמסכה בתנאי שימוש רגילים ובכפוף לפרוטוקולי הניקוי והתחזקה המומלצים. עם זאת, כרית הג'ל יכולה להיוורס. היא תקרע, תיתפרק או מתנתק ממקומה אם יועשה בה שימוש לא נאות או יופעל עליה כוח בלתי סביר. אין ליקות במדיום כלים. האחוויות לא מכסה בעיות בחומר גנטיסות בלבד. לפיכך, הקפד להשתמש במסכתה אף החדשה בעלת חורי האוורור מסוג Phantom® באזורות הרבה.

**זהירות:** תדריות הניקוי, שיטות הניקוי או השימוש בחומר ניקוי באופן שלא עולה בקנה אחד עם המתואר לעיל או שימוש בהתקן מעבר לשך חי השירות של רכיביו - כל אלה עלולים להשפיע לרעה על ההתקן ולגרוע בעקבות זאת מבטיות או איות הטיפול.

### **מידע טכני**

טוח לחיצי הטיפול: עד 30 ס"מ מים  
התנגדות לזרימת אויר בקצב 50 ל"ד/דקלה: 0.45 ס"מ מים  
התנגדות לזרימת אויר בקצב 100 ל"ד/דקלה: 2.06 ס"מ מים  
נפח חלל מת מ"ל בקירות: מסכה – 30.7 מ"ל צינור – 68.3 מ"ל  
טמפרטורת הפעלה: און לחשוף את המסכה לטמפרטורות מעל 50°F (122°F)

### **טרם השימוש**

◀ בחרן את מסכה מהSKU. התאמת רצונות הבסיס למידה הכללית שלך, לשם כך משוך את הלשונית עד נקודות חלחליה או אם הג'ל נחשף בעקבות קרעים או נקבים.

## **2 - הוואות התאמת לפנים - PHANTOM®**

1. הוצאת המסכה מהSKU. התאמת רצונות הבסיס למידה הכללית שלך, לשם כך משוך את הלשונית עד לסימון המידה המתאים (S, M, L, XL). (איור 1).
2. נתק תפס מגנטי אחד מהמסכה. (איור 2).
3. לאחר הנחת המסכה על הפנים, ברר מחדש את התפס המגנטי. (איור 3).
4. ראשית, התאמת הראשונה השמאלית או הימנית כדי לוודא שמתניתה המסכה אטומה ושהמסכה מונחת בצד נוחה מעל השפה העליונה ומגיעה עד לגשר האף. (איור 5).
5. נתק תפס מגנטי אחד מהמסכה. (איור 6).
6. חסר את המסכה לצינור המנשק שיוצר לחץ חזבי בדרכי הנשימה, והדליך את המכשיר כך ישיפק את הלחץ שנדרש. סובב את הראש מצד לצד תוך שכיבה על מיטה כדי להבטיח שהמסכה מותאמת לפנים ומהודקת אליהם. (איור 6).
7. אם מתרחשות דליפות שלא אמורים לקרה, נסה להוציא את המסכה מעלה או מטה סביב האף ולמצוא את המנת המתאים ביזור. (איור 7).
8. לחץ בעדרינות על קצוות המסכה כדי לשנות את צורתה, כדי להתאים להפניות בצד שמאל או ימין. (איור 8).
9. אם הדליפות נמשכות, נסה להוציא את המסכה מעלה או מטה סביב האף ולמצוא את המנת המתאים ביזור. (איור 9).

### **הוראות פירוק**

1. אחוז בחזקה בכרית המסכה בידי אחת בלבד מצדית. (איור 1).
2. אחוז באחד המגנטים של מסגרת הסביבול. (איור 2).
3. משוך והפרד את מסגרת הסביבול מהכרית בתנועת קילוף. (איור 3).

### **הוראות הרכבה**

1. הטה את מסגרת הסביבול מעט מעלה וקרב אותה למסכה (איור 1). לחץ באמצעות האצבעות על טבעת האיטום של המסכה מהצד הפנימי.
2. החלק את החלק העליון של מסגרת הסביבול לתוך המסכה עד שנייה המסכה יינעלו בחריצי מסגרת הסביבול (איור 2).

3. דחף בעדינות את החלק התיכון של מסגרת הסביבול לתוכה המסכה עד שלשונית מסגרת הסביבול תינעל למקוםה (איור 3).

4. הסתכל על הצד הפנימי של המסכה כדי לוודא שטבעת האיתום ממקמת כיאות על מסגרת הסביבול (איור 4).

.Sleepnet Corporation **Phantom®2**

.[www.sleepnetmasks.com](http://www.sleepnetmasks.com) בקר באתר האינטרנט שלנו בכתב

This page intentionally left blank.

Explanation of Symbols / Explicación de los símbolos /  
 Explicação dos símbolos/ Пояснение символов/ 記号の説明 /  
 شرح الرموز  
 הסבר אוזות הסמלים

---



**Caution or Warning**

Precaución o advertencia

Precavações ou advertências

Внимание или Осторожно

注意または警告

تنبيه أو تحذير

זהירות או אזהרה



**Refer to Instructions for Use**

Consulte las instrucciones de uso

Consulte as instruções de utilização

См. инструкции по применению

使用説明書を参照

راجع ارشادات الاستعمال

עיין בהוראות השימוש



**Lot number**

Número de lote

Número de lote

Номер партии

ロット数

رقم التشغيلة

مسنفر أصوحة



**Use by Date**

Fecha de caducidad

Prazo de validade

Использовать до указанной даты

使用期限

يُستخدم قبل التاريخ

לא可以用後到期日



**Does not contain natural rubber latex**

No contiene látex de caucho natural

Não contém látex de borracha natural

Не содержит натурального каучукового латекса

天然ゴムラテックスを含まない

لا يحتوي على لاتكس مطاطي طبيعي

לא מכיל גומי טבעי (לטקס)



**Medical Device**

Producto sanitario

Dispositivo médico

Медицинское устройство

医療機器

جهاز طبي

מכשיר רפואי



**Manufacturer**

Fabricante

Fabricante

Изготовитель

製造元

الجهة المصنعة

יצן



**Date of Manufacture**

Fecha de fabricación

Data de fábrico

Дата изготавления

製造日

تاريخ التصنيع

תאריך ייצור



**Part number**

Referencia

Número de peça

Номер по каталогу

部品番号

رقم القطعة

מספר חלק



**Not MRI Safe**

No segura para resonancia magnética

Não seguro para ressonânciа magnética

Не безопасно для МРТ

MRIに対して安全ではありません

غير آمن حين الاستخدام مع التصوير بالرنين المغناطيسي

לא בטוח לשימוש בסביבת תהודה מגנטית